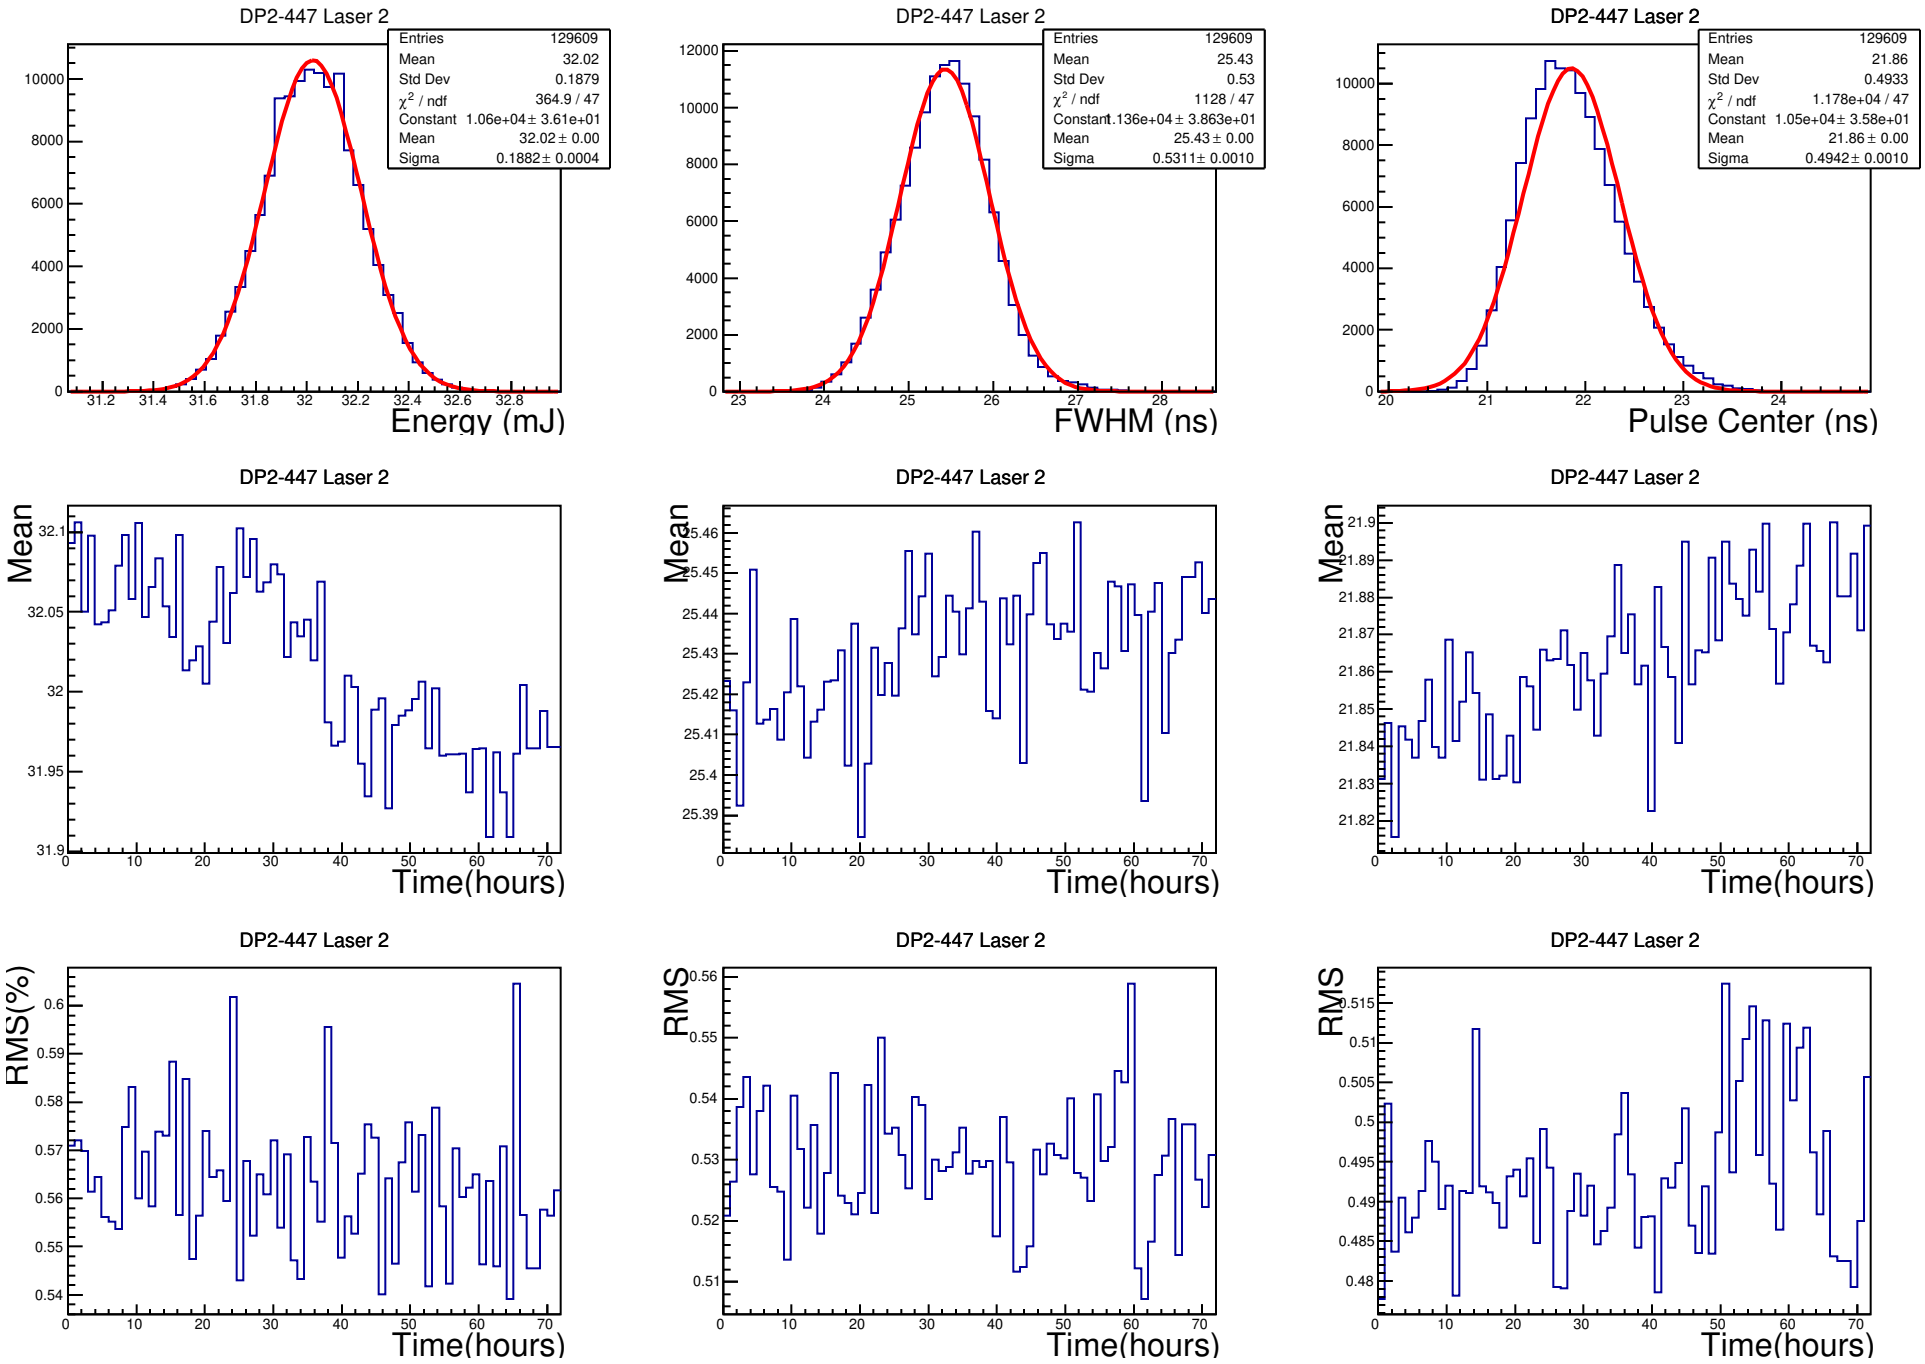
DP2-447 Laser 2
Entries 129609
Mean 32.02
Std Dev 0.1879
χ2 / ndf 364.9 / 47
Constant 1.06e+04 ± 3.61e+01
Mean 32.02 ± 0.00
Sigma 0.1882 ± 0.0004
Energy (mJ)
DP2-447 Laser 2
Entries 129609
Mean 25.43
Std Dev 0.53
χ2 / ndf 1128 / 47
Constant 1.136e+04 ± 3.863e+01
Mean 25.43 ± 0.00
Sigma 0.5311 ± 0.0010
FWHM (ns)
DP2-447 Laser 2
Entries 129609
Mean 21.86
Std Dev 0.4933
χ2 / ndf 1.178e+04 / 47
Constant 1.05e+04 ± 3.58e+01
Mean 21.86 ± 0.00
Sigma 0.4942 ± 0.0010
Pulse Center (ns)
DP2-447 Laser 2
Mean
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
Mean
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
Mean
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
RMS(%)
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
RMS
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
RMS
Time(hours)

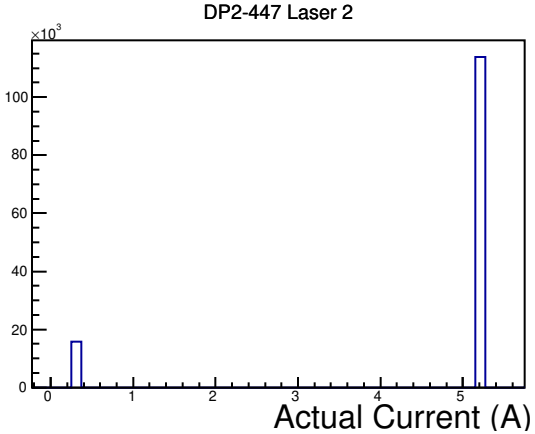
DP2-447 Laser 2
×10^3
Actual Current (A)

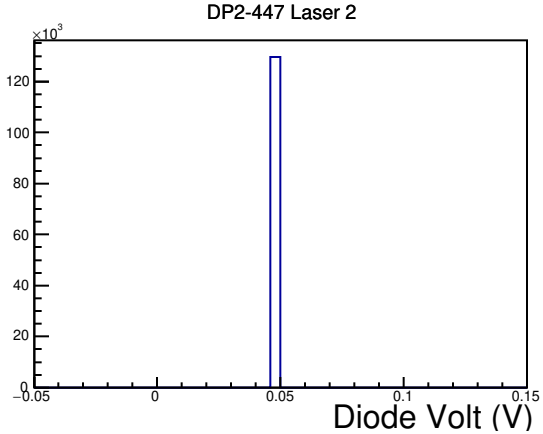
DP2-447 Laser 2
×10^3
Diode Volt (V)

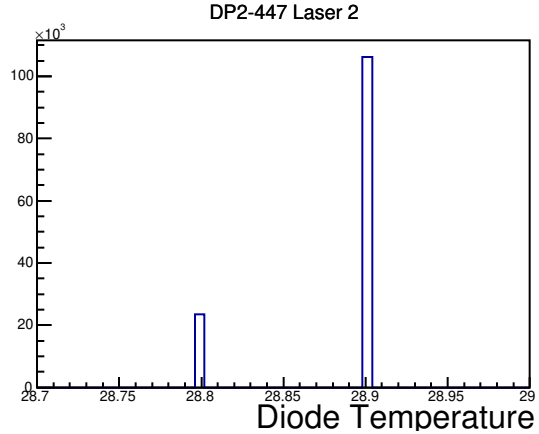
DP2-447 Laser 2
×10^3
Diode Temperature

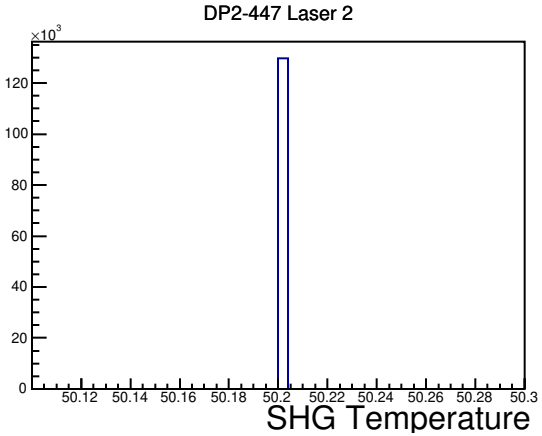
DP2-447 Laser 2
×10^3
SHG Temperature

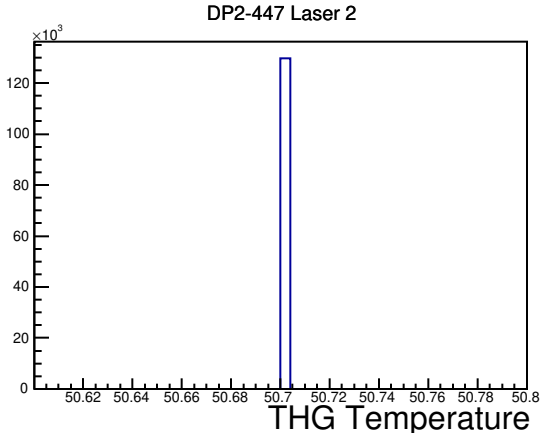
DP2-447 Laser 2
×10^3
THG Temperature

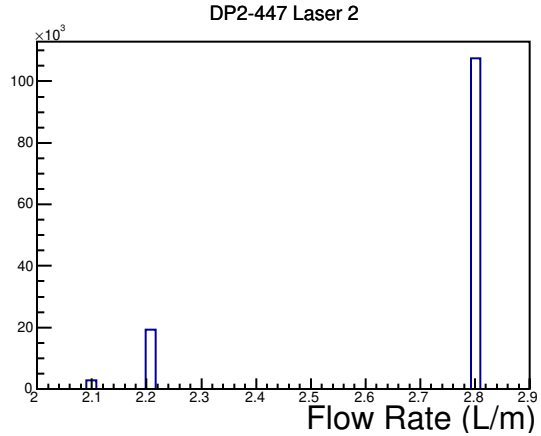
DP2-447 Laser 2
×10^3
Flow Rate (L/m)

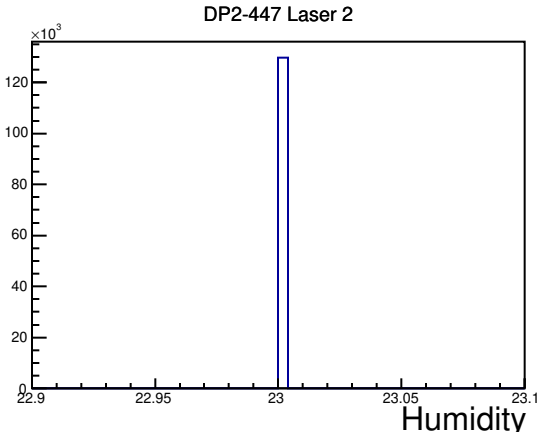
DP2-447 Laser 2
×10^3
Humidity

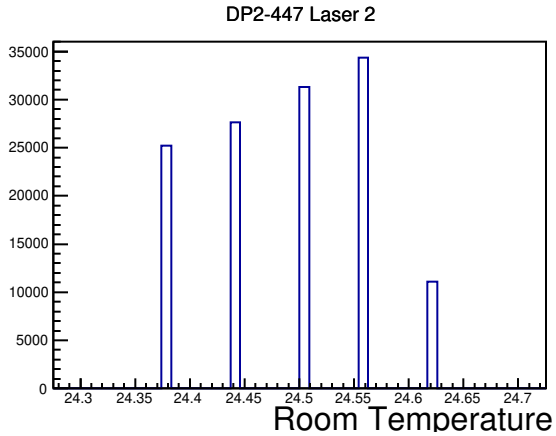
DP2-447 Laser 2
Room Temperature

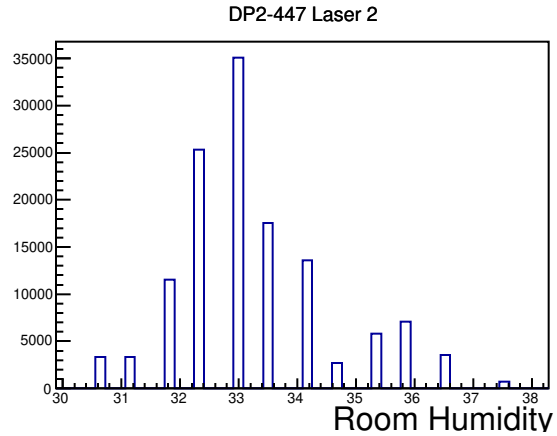
DP2-447 Laser 2
Room Humidity

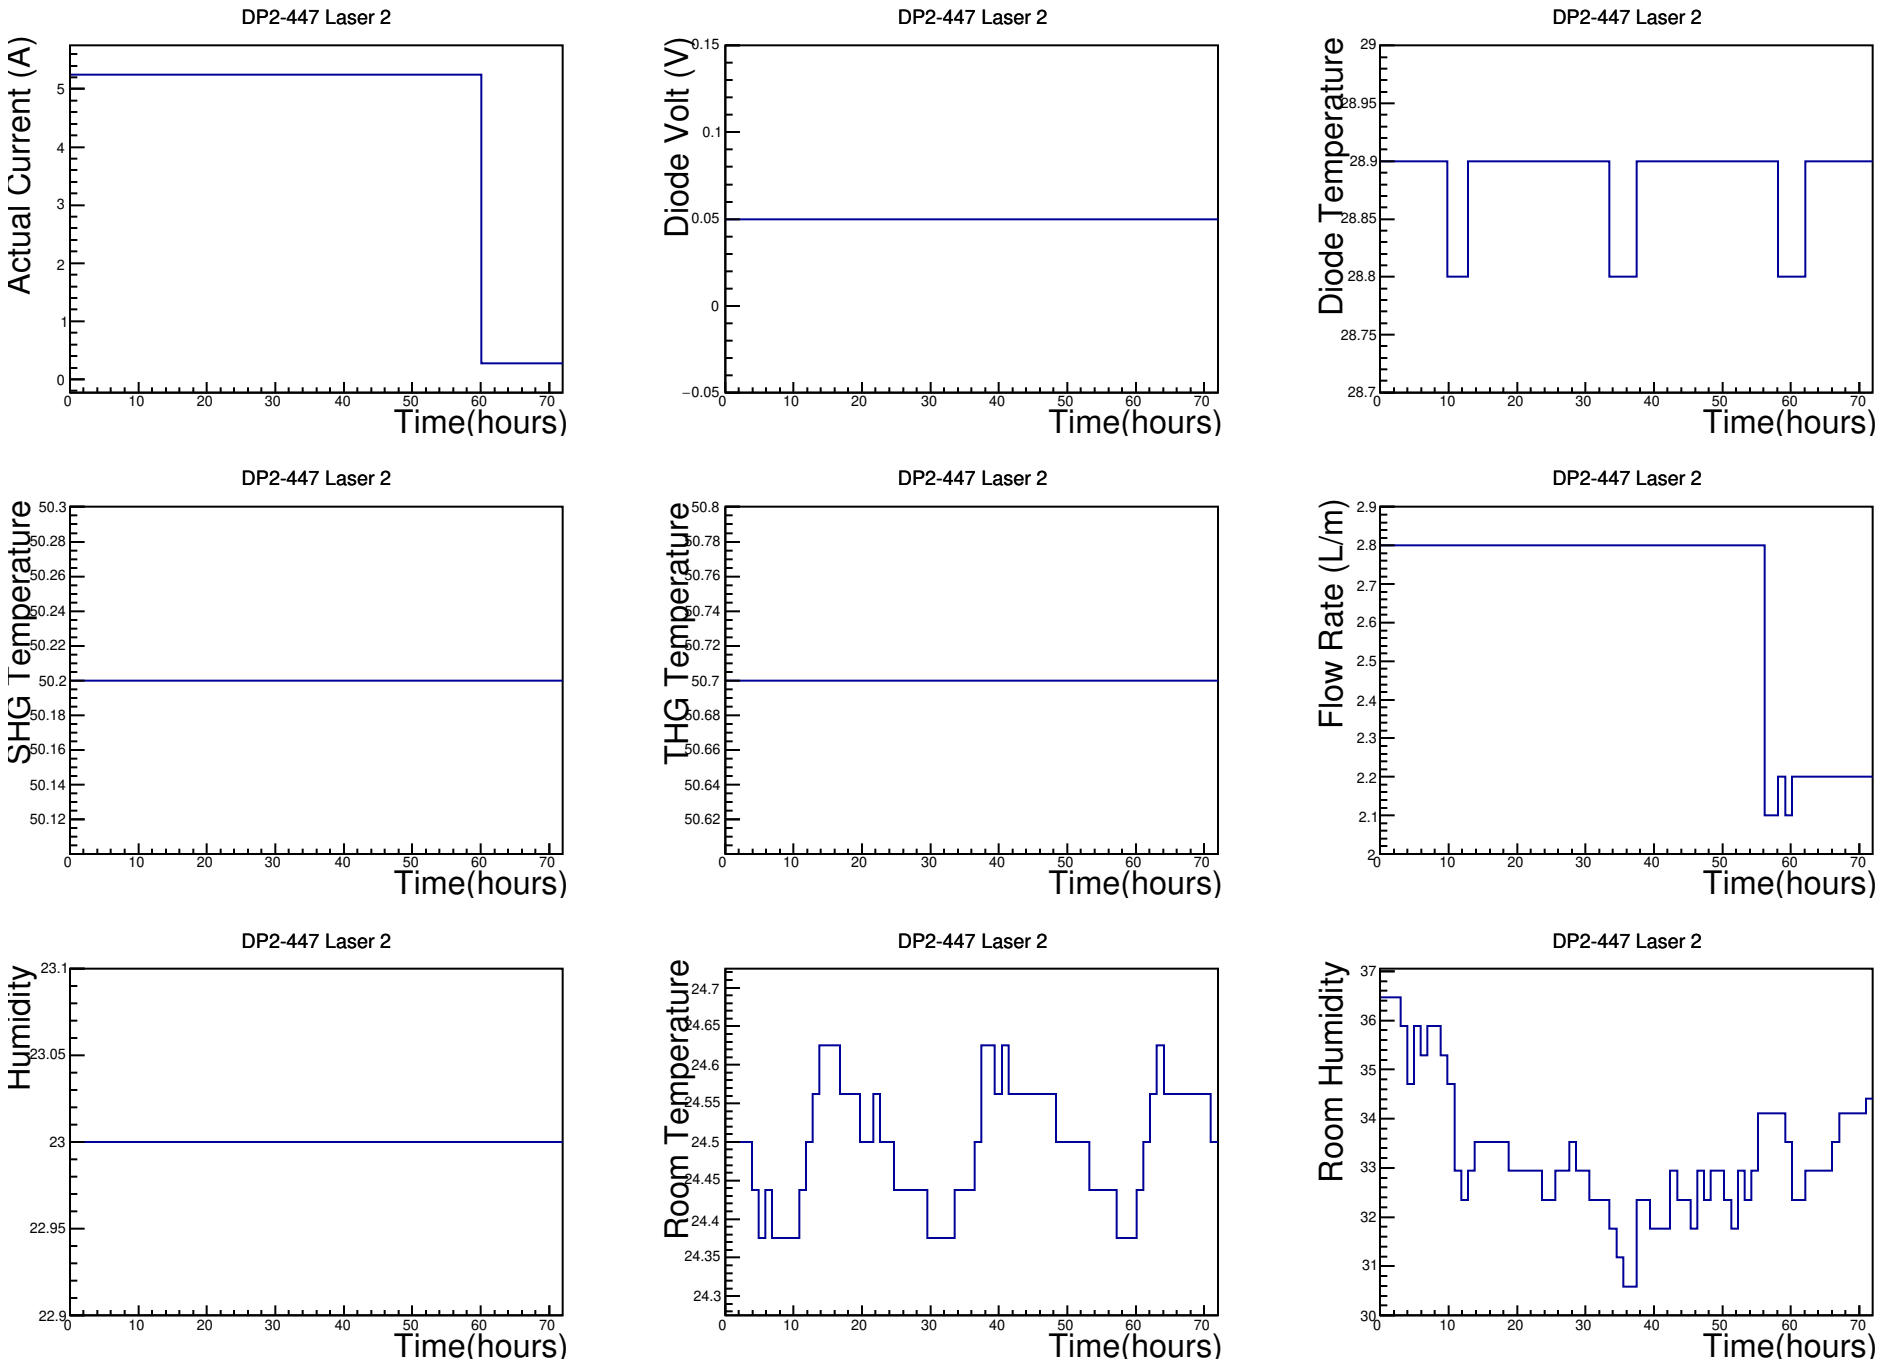
DP2-447 Laser 2
Actual Current (A)
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
Diode Volt (V)
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
Diode Temperature
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
SHG Temperature
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
THG Temperature
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
Flow Rate (L/m)
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
Humidity
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
Room Temperature
Time(hours)
DP2-447 Laser 2
Room Humidity
Time(hours)